



ประกาศโรงพยาบาลบ้านผือ

เรื่อง ดำเนินการประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วย โรงพยาบาลบ้านผือ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการที่ชำรุด จำนวน ๒๒ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลราคาให้นำบัตรประชาชนพร้อมถ่ายสำเนาลงทะเบียนได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. (ผู้มีสิทธิที่จะเข้าเสนอราคาประมูลจะต้องมีการลงทะเบียนในวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นหากไม่ลงทะเบียนไม่มีสิทธิประมูลราคา)

๒. สามารถดูสิ่งของที่ประมูลได้ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านผือ หากผู้ประมูลรายใดไม่ไปดูสิ่งของที่จำหน่ายให้ถือว่าผู้ประมูลทราบแล้ว

๓. ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องเสนอราคา โดยใช้แบบฟอร์มของทางโรงพยาบาลบ้านผือ กำหนดไว้เท่านั้นและยื่นของเสนอราคาด้วยตนเอง หรือทำหนังสือมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่รับของเสนอราคา ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านผือ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๐-๑๐.๐๐ น. เท่านั้น หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ

๔. คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาจะเปิดซองเสนอราคาวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๑๕ น.

๕. ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องเสนอราคาซื้อ ดังนี้

- พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๒๒ รายการ ราคากลาง ๑๕,๘๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบ บาทถ้วน) ได้แก่ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องถ่ายภาพX-ray เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้มิฉะนั้นโรงพยาบาลบ้านผือ ถือว่าผู้เสนอราคาผิดเงื่อนไข ไม่รับพิจารณา

๖. ผู้ประมูลราคาได้จะต้องชำระเงินสดตามราคาที่ประมูลได้ทั้งหมดในวันที่ประมูล นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นผู้ประมูลราคาได้ และจะต้องขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ประมูลราคาได้ชำระเงินครบถ้วน หากไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้ประมูลสละสิทธิ ซึ่งจะเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆจากทางราชการมิได้ทั้งสิ้น

๗. ในการเสนอราคา ถ้าคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่า ราคาที่ผู้เสนอราคาสูงสุดเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการขายทอดตลาดสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดในครั้งนี้ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ

๘. ผู้ประมูลราคาได้จะต้องขนย้ายวัสดุพร้อมทั้งทำความสะอาดให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันชำระเงินทั้งหมดครบถ้วน หากไม่สามารถขนย้ายสิ่งของที่ประมูลได้ออกไปหมดตามกำหนดเวลา ผู้ประมูลราคาได้ต้องยินยอมให้ทางโรงพยาบาลบ้านผือ คิดค่าปรับวันละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ต่อวัน นับถัดจากวันครบกำหนดขนย้ายสิ่งของออกไปจากที่เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โดยประกาศฉบับนี้ โรงพยาบาลบ้านผือ ถือว่า ผู้เสนอราคาทุกราย ได้ทราบเงื่อนไขการขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว และคณะกรรมการขายทอดตลาดจะได้อ่านให้ฟังก่อนเริ่มต้นการประมูลราคาขายทอดตลาดอีกด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านผือ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

รายการครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาด

ลำดับ	รายการ	รหัสครุภัณฑ์	จำนวน	ราคากลาง (บาท)	ราคา	ขอจำหน่าย โดยวิธี	หมายเหตุ
1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทาง หลอดเลือดดำ	6515-047-0003/01-21	21	50	1,050	ขายทอดตลาด	ชำรุดใช้งานไม่ได้
2	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล (แบบพกพา)	6515-369-0009/01-14	14	50	700	ขายทอดตลาด	ชำรุดใช้งานไม่ได้
3	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก (แบบปรอท)	6515-369-0001/01-02	2	20	40	ขายทอดตลาด	ชำรุดใช้งานไม่ได้
4	เครื่องดูดของเหลว	6515-036-0001/01	1	50	50	ขายทอดตลาด	ชำรุดใช้งานไม่ได้
5	เครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด (แบบ ปลายนิ้ว)	6515-026-0002/01	1	20	20	ขายทอดตลาด	ชำรุดใช้งานไม่ได้
6	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	6515-038-0001/01	1	200	200	ขายทอดตลาด	ชำรุดใช้งานไม่ได้
7	เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจทารกใน ครรภ์	6515-027-1005/01	1	100	100	ขายทอดตลาด	ชำรุดใช้งานไม่ได้
8	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ	6515-027-1002/01-04	4	50	200	ขายทอดตลาด	ชำรุดใช้งานไม่ได้
9	เครื่องอัลตราซาวด์	4610-007-0003/01	1	250	250	ขายทอดตลาด	ชำรุดใช้งานไม่ได้
10	ตู้อบทารก	6515-095-0001/01-02	2	100	200	ขายทอดตลาด	ชำรุดใช้งานไม่ได้
11	เครื่องให้ความอบอุ่นแก่ทารก	6515-031-0202/01-03	3	100	300	ขายทอดตลาด	ชำรุดใช้งานไม่ได้
12	ยูนิตทำฟัน	6520-007-0001/01-03	3	1500	4,500	ขายทอดตลาด	ชำรุดใช้งานไม่ได้
13	เครื่องปั่นเหวี่ยง	6515-014-1012/01	1	50	50	ขายทอดตลาด	ชำรุดใช้งานไม่ได้
14	เครื่องหมุนเหวี่ยงเม็ดเลือดแดงอัดแน่น	6515-014-0003/01	1	50	50	ขายทอดตลาด	ชำรุดใช้งานไม่ได้
15	ชุดควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจน + เรกูเลเตอร์	6515-039-0004/01	1	50	50	ขายทอดตลาด	ชำรุดใช้งานไม่ได้
16	เครื่องถ่ายภาพX-ray	6525-004-0002/01-02	2	2500	5,000	ขายทอดตลาด	ชำรุดใช้งานไม่ได้
17	รถเข็นผู้ป่วยแบบพับได้	6530-038-1101/01-23	23	20	460	ขายทอดตลาด	ชำรุดใช้งานไม่ได้
18	รถเข็นนอน	6530-013-0001/01-08	8	100	800	ขายทอดตลาด	ชำรุดใช้งานไม่ได้
19	เตียงสแตนเลส	6530-001-0002/01-10	10	100	1,000	ขายทอดตลาด	ชำรุดใช้งานไม่ได้
20	รถเข็นผู้ป่วยแบบปรับเอน	6530-013-0002/01-02	2	20	40	ขายทอดตลาด	ชำรุดใช้งานไม่ได้
21	รถเข็นนั่ง	6530-038-0001/01-03	3	20	60	ขายทอดตลาด	ชำรุดใช้งานไม่ได้
22	โครมไฟฟ้าตัด	6530-002-0000/01	1	750	750	ขายทอดตลาด	ชำรุดใช้งานไม่ได้
รวมเงินที่คาดว่าจะขายได้ทั้งสิ้น			106		15,870.00		

(.....)

(นางชลีพร แดนสุข)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
คณะกรรมการประเมินราคา

(.....)

(นางฉวีวรรณ ท้าวมะลิ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
คณะกรรมการประเมินราคา

(.....)

(นายสุชาติ ผิวม่วง)
พนักงานขับรถยนต์
คณะกรรมการประเมินราคา

การจำหน่ายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ชนิดเครื่องมือแพทย์


โรงพยาบาลบ้านฝ้อ 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กอง สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข


รายการเครื่องมือแพทย์ 1

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Infusion Pump

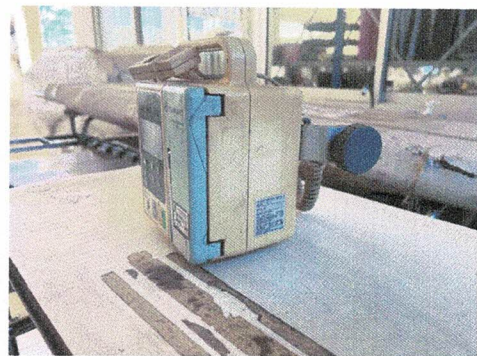

รายการเครื่องมือแพทย์ 2

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล Digital Blood Pressure

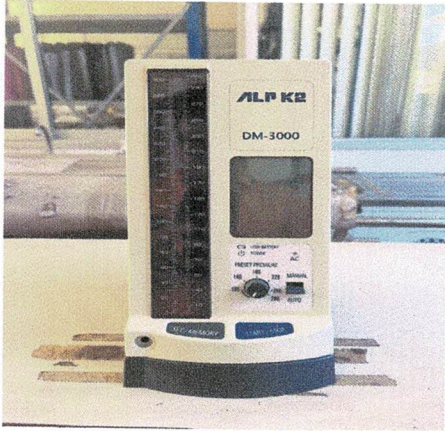

รายการเครื่องมือแพทย์ 3

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก manual sphygmomanometer



รายการเครื่องมือแพทย์ 4

เครื่องดูดของเหลว SUCTION




รายการเครื่องมือแพทย์ 5

เครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด Pulse Oximeter Fingertip




รายการเครื่องมือแพทย์ 6

เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ Nonstress test (NST)

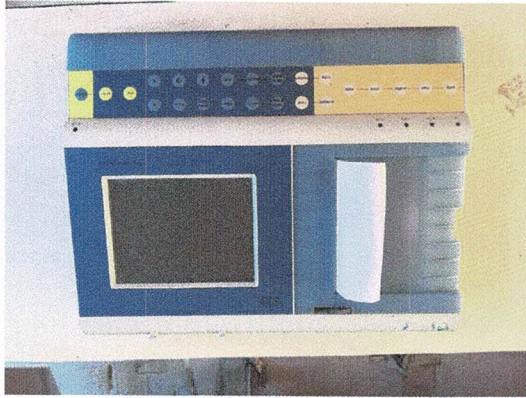


รายการเครื่องมือแพทย์ 7

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (ECG or EKG)

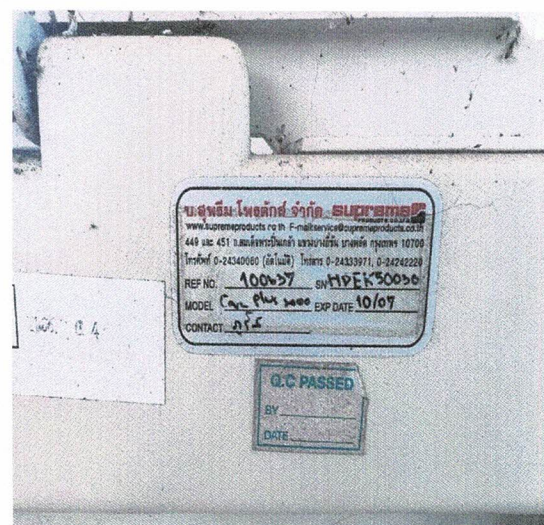

รายการเครื่องมือแพทย์ 8

เครื่องติดตามสัญญาณชีพ Parameter Patient Monitor

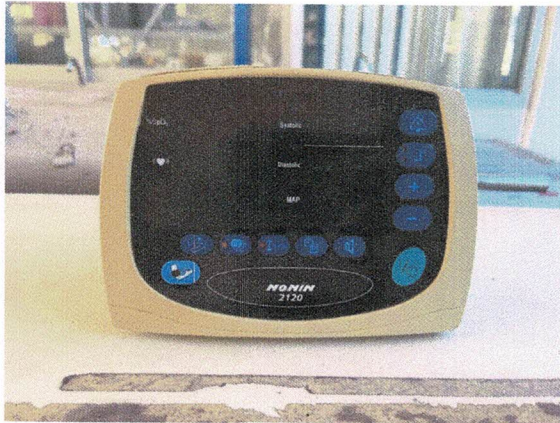

รายการเครื่องมือแพทย์ 9

เครื่องอัลตราซาวด์ Ultrasound



รายการเครื่องมือแพทย์ 10

ตู้อบทารก Infant Incubator



รายการเครื่องมือแพทย์ 11

เครื่องให้ความอบอุ่นแก่ทารก Radiant Warmer



รายการเครื่องมือแพทย์ 12

ยูนิตทำฟัน Dental Unit



รายการเครื่องมือแพทย์ 13

เครื่องปั่นเหวี่ยง Serofuge Centrifuge



รายการเครื่องมือแพทย์ 14

เครื่องหมุนเหวี่ยงเม็ดเลือดแดงอัดแน่น Hematocrit Centrifuge




รายการเครื่องมือแพทย์ 15

ชุดควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจน + เรกูเลเตอร์ Oxygen Regulate & Flow Meter



รายการเครื่องมือแพทย์ 16
เครื่องถ่ายภาพ X-ray

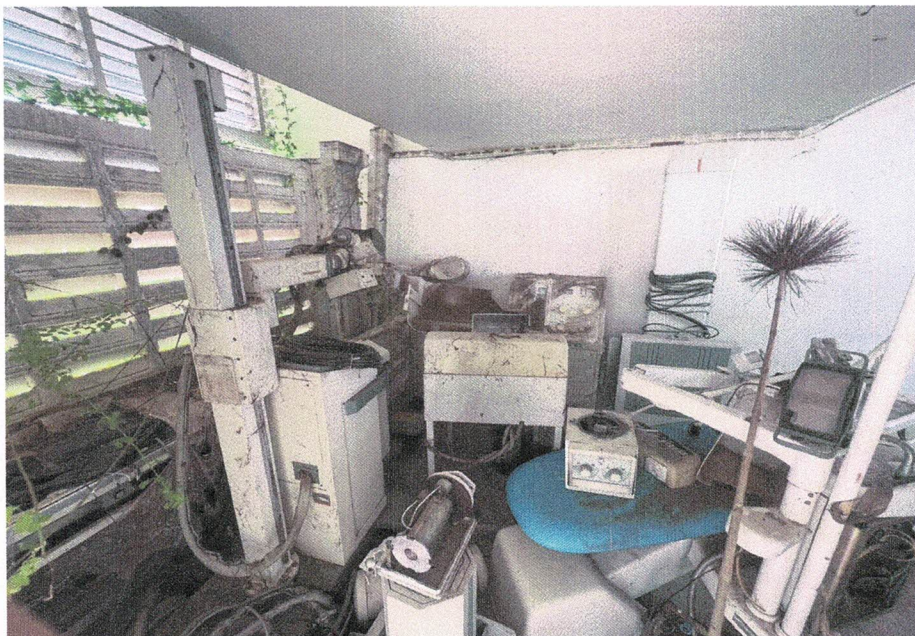

รายการเครื่องมือแพทย์ 17
รถเข็นนั่งผู้ป่วยแบบพับได้



รายการเครื่องมือแพทย์ 18

รถเข็นนอน



รายการเครื่องมือแพทย์ 19

เตียงสแตนเลส



รายการเครื่องมือแพทย์ 20

รถเข็นนั่งผู้ป่วยแบบปรับเอน



รายการเครื่องมือแพทย์ 21

รถเข็นนั่ง



รายการเครื่องมือแพทย์ 22

โครมไฟฟ้าตัด

